

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5  
ORISTANO

700  
28/11/12  
h

Prot. N° 4144774

UFFICIO PROTESI - DISTRETTO

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 3 fogli

Oristano, li 26.11.2012

OGGETTO: assistiti aventi diritto per acquisto presidi  
sanitari D.M. 27 agosto 1999, n. 332.

Al Servizio Provveditorato


SEDE

In riferimento alla richiesta del Sig. [redacted], prot. n° 76750 del 26.11.2012, tendente ad ottenere la fornitura di presidi sanitari, in quanto affetto da [redacted], allegato alla presente si trasmette la richiesta per l'acquisto dei presidi sanitari di cui all'oggetto. dell'assistito [redacted]

- Apparecchio di supporto alla tosse "FREE ASPIRE" marca MPR con accessori d'uso, Codice ISO 03.03.15;


Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
- Dr. Antonio Delabona -



L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

- Fausto Spanu -

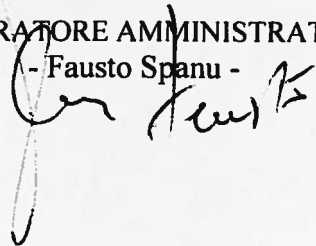

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano

Allegato 1

**ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA**  
**Modello di Prescrizione Specialistica**

ASSISTITO

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_ ETÀ: \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' E PROGRAMMA RIABILITATIVO**

Diagnosi clinica \_\_\_\_\_

Valutazione del deficit \_\_\_\_\_

Valutazione funzionale e abilità residue \_\_\_\_\_

Valutazione delle attività, azioni da supportare e/o compensare Assistenza alle tone

Obiettivi riabilitativi in relazione alla valutazione delle abilità motorie, intellettive e ambientali compatibili con il presidio proposto  
Prevenzione delle complicanze riferite al rischio di secrezioni bronchiali

Tempi di impiego previsti \_\_\_\_\_

**PRESIDI PROPOSTI**

DESCRIZIONE PRESIDIO	Codice Tariffario	Codice ISO	Quantità
<u>FREE ASPIRE-MPR con accessori d'uso</u>	<u>601-M.01</u>	<u>03.03-15</u>	<u>1</u>
<u>Le p. è stata adottata con buoni risultati e buona compliance allo strumento richiesto</u>			

Qualora il presidio non sia espressamente contemplato nel NT e sia riconducibile, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del DM 332/99 per omogeneità funzionale, apporre la dicitura "riconducibile per omogeneità funzionale"

In caso di fornitura successiva alla prima indicare:

- a. se trattasi di fornitura che ha superato i tempi minimi di rinnovo ed è  guasto  rotto  usurato  
 data dell'ultima fornitura \_\_\_\_\_ dichiaro che non è convenientemente riparabile

b. se trattasi di fornitura che ha **non superato** i tempi minimi di rinnovo

(condizioni di cui al co. 3 dell'art. 5 del D.M. 332/99).

.trattasi di presidio:  guasto  rotto  usurato  sostituzione componenti usurate  
 Altro \_\_\_\_\_  dichiaro che non è convenientemente riparabile

(condizioni di cui al co. 2 dell'art. 5 del D.M. 332/99).

modifica dello stato psico-fisico (allegare relazione dettagliata)  
 particolari necessità terapeutiche (allegare relazione dettagliata)

c. se trattasi di **minore di anni 18**

rinnovo dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva  
 rinnovo non dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva ma ai casi di cui sopra (indicare)

### Situazione dell'avente diritto

Lettera a dell'art. 2 del D.M. 332/99

**invalido già riconosciuto** (invalido civile, di guerra, di servizio, privo di vista, sordomuto)

**invalido già riconosciuto** per il quale viene richiesta assistenza protesica non correlata alla invalidità riconosciuta

trattasi di invalido con invalidità > al 33% e fino al 100% senza indennità di accompagnamento  
riconosciuta: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992

trattasi di invalido al 100% con indennità di accompagnamento **riconosciuta**: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992

**minore di anni 18**, per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità permanente


Lettera b dell'art. 2 del D.M. 332/99

**istante in attesa di accertamento di invalidità**

trattasi di assistito per il quale sussistono le condizioni di cui alla legge 18/80 in quanto si trova nella "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua": la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992

*Or. 21-11-2012*

**Lo Specialista**

  
Azienda A.R.L. N°5 - ORISTANO  
Fresia Pneumotisiologia  
Dott.ssa Pietrina Murgia

### Note:

La presente prescrizione deve essere accompagnata dalla prescrizione dei presidi su ricettario SSN

**MS****MEDICAL SERVICES**  
di Antonio MuraAllegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 2 fogli07100 SASSARI - VIA FRATELLI ROSSELLI N. 4/A  
Tel 079-2111504 - Fax 079-216876C.C.I.A.A. SS R.L. 183763/1996  
P. IVA n. 01404210906Sassari 13/04/2012  
Ns. Rif. A13/04-GCSPETT.LE  
AZIENDA U.S.L. N. 5  
SERVIZIO ACQUISTI  
VIA CARDUCCI N. 35  
- ORISTANO -c.g. Sig.ra Eleonora Faa

OGGETTO: Incarico di distribuzione anno 2012.

Spett.le Amministrazione, io sottoscritto Antonio Mura, titolare della Ditta M.S. Medical Services di Antonio Mura con sede a Sassari in via Fratelli Rosselli n. 4/A, in qualità di rivenditore ospedaliero, in esclusiva per la Regione Sardegna, dell'apparecchiatura FREE ASPIRE, dichiaro di aver assegnato, per l'anno 2012, incarico di distribuzione per le province di Cagliari ed Oristano alla Società MEDAX s.r.l.

Distinti saluti

M.S. MEDICAL SERVICES

*Antonio Mura*



Legnano, 29 marzo 2012


A chi di competenza

**OGGETTO:** contratto di distribuzione 2012

La presente per dichiarare che la società MS Medical Service con sede a Sassari in Via F.lli Rosselli, 4a è il distributore esclusivo delle forniture ospedaliere nella regione Sardegna per l'anno 2012 dell'apparecchiatura FREE ASPIRE di nostra produzione.

In Fede

**Medical Products Research S.r.l.**

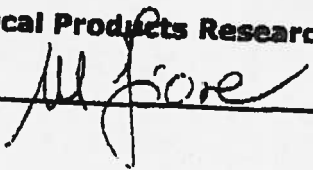  
\_\_\_\_\_



Medical Products Research Srl  
Capitale sociale euro 10.000 interamente versato  
Registro imprese Tribunale di Milano n° 04984420960  
Rsa Milano n° 1767932  
Codice fiscale 04984420960 Partita IVA 04984420960

Sede legale  
Piazza Iv Novembre, 5 - 20025 Legnano (MI)  
Sede amministrativa  
Via S. Lega, 48 - 20025 Legnano (MI)  
Tel + 39 0331 597 992  
Fax + 39 0331 405 089

www.mpr-italy.it  
e-mail info@mpr-italy.it



**MEDAX** s.r.l.

07100 SASSARI - VIA ROSSELLI N. 4/A  
Tel. n. 079/2111504 - Fax n. 079/216876  
C.C.I.A.A. SS - R.E.A n. 141498  
P. IVA n. 02006260901

Stampa con dati amministrativi e numeri di protocollo. Contiene i numeri 3 e 4.

Allegato n° 3 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 4 fogli

Sassari 29/03/2012  
Ns. Rif. A29/03-GC

Spett.le  
Azienda U.S.L. n. 5  
Servizio Provveditorato  
Via Carducci n. 35  
- Oristano -

**OGGETTO:** Offerta per la fornitura di un apparecchio "FREE ASPIRE"  
Rif. Vs. Prot. n. 21773 / E.F. del 27/03/2012.

Sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione ns. offerta per la fornitura del materiale di seguito elencato.

N. 01 Pz. Art. MPR100/M - Apparecchio per la tosse FREE ASPIRE, orig. MPR, completo di accessori d'uso.

Prezzo unitario IVA esclusa: € 2.850.00 (duemilaottocentocinquanta/00)

Prezzo unitario IVA inclusa: € 2.964.00 (duemilanovecentosessantaquattro/00)



**Condizioni di fornitura:**

- IVA 4% Vs. carico;
- Validità dell'offerta: sino al 31/12/2012;
- Tempi di consegna: 20 gg.;
- Imballo gratis - consegna e collaudo ns. carico c/o domicilio paziente;
- Garanzia: mesi 12 dalla data del collaudo;
- Pagamento a mezzo Bonif. Bancario 90 gg. D.R.F.

Distinti saluti

**MEDAX** s.r.l.  
L' Amministratore

inspiration in respiratory therapy



FREE ASPIRE

**MEDAX SRL**  
Via F.lli Rosselli, 4/A - 07100 SASSARI  
Tel. 079 2111504 - Fax 079 216876  
Pat. IVA 02006260901



Medical Products

**ASPIRATORE DI SECREZIONI  
CON TECNOLOGIA VAKÜM**

**FREE ASPIRE**



**FREE ASPIRE** è un'apparecchiatura elettromedicale in grado di rimuovere le secrezioni bronco-polmonari in maniera non invasiva senza l'impiego di sonde e senza generare tosse.

- FACILE** ——— | **l'utilizzatore respira normalmente a volume corrente**
- SICURO** ——— | **nessuna pressione positiva o negativa è generata all'interno delle vie aeree**
- EFFICACE** ——— | **è possibile l'impiego anche in pazienti con scarso riflesso della tosse**

CE 0051

MEDIUM

**CAMPI DI IMPIEGO CLINICO**

Pazienti con ridotta capacità espettorante. Alleviare i sintomi della malattia respiratoria cronica migliorando la qualità della vita e prevenendo le complicanze. **FREE ASPIRE** può inoltre essere utilizzato per rimuovere le secrezioni senza il rischio di provocare danni.

**Fibrosi Cistica**  
La rimozione delle secrezioni nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica impedisce la loro risalita ed è vitale. **FREE ASPIRE** è progettato con la nuova tecnologia brevettata denominata **VAKÜM** in grado di mobilizzare le secrezioni particolarmente dense e vischiose tipiche della patologia.

- BPCO
- BRONCHIECTASIE
- PEDIATRIA
- PREPARAZIONE PRE CHIRURGICA PAZIENTI BPCO
- RIABILITAZIONE POST INTERVENTO TORACICO- ABDOMINALE
- RIABILITAZIONE POST INTERVENTO CARDIO-CHIRURGICO

**CONTROINDICAZIONI RELATIVE:**  
potenziale di ipertensione sistemica






**FREE ASPIRE** utilizza una nuova tecnologia brevettata denominata **VAFUM** in grado di avvicinare il flusso espiratorio. In completa assenza le resistenze raggiungono le prime vie aeree dando la possibilità al paziente di espellere e di deglutire le secrezioni con un grado di eliminazione superiore.

Il paziente non è sottoposto ad un lavoro di spinta durante lo scoppio e quindi a lesioni. Con una forza espiratoria di 10 cm H<sub>2</sub>O il paziente espelle le secrezioni e le espelle proficua al contrario che i sistemi di aspirazione a vuoto. Durante la fase espiratoria il paziente respira e proficua al lavoro di spinta ad un ritmo di lavoro normale. Nella fase di aspirazione il paziente non è sottoposto ad un lavoro di spinta.

La resistenza non è nulla, mentre tutto l'apparato polmonare coltiva il lavoro, ecc. ed ha una forza sulla quale il paziente non è sottoposto. Il paziente non è sottoposto ad un lavoro di spinta durante lo scoppio e quindi a lesioni. Con una forza espiratoria di 10 cm H<sub>2</sub>O il paziente espelle le secrezioni e le espelle proficua al contrario che i sistemi di aspirazione a vuoto. Durante la fase espiratoria il paziente respira e proficua al lavoro di spinta ad un ritmo di lavoro normale. Nella fase di aspirazione il paziente non è sottoposto ad un lavoro di spinta.

Non è un sistema negativo e genera all'utente un volume portante non solo durante la fase di aspirazione della secrezione.

Il paziente non soffre in quanto a volume di aspirazione di un aumento della ventilazione. Il sistema è un sistema di una classe elettrica portante e delle norme portanti con classe elettrica di classe II. Il sistema è un sistema di una classe elettrica portante e delle norme portanti con classe elettrica di classe II.

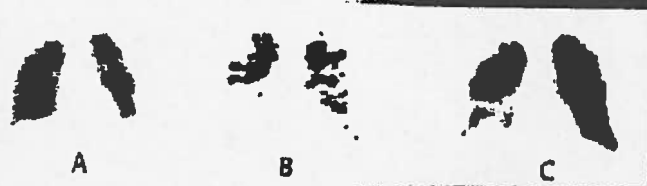

Immagini radiologiche ottenute durante l'impiego di FREE ASPIRE. Si nota l'assenza di secrezioni (A) con buona presenza della fase di aspirazione (B). Dopo l'impiego di FREE ASPIRE (C) il paziente è sottoposto ad un lavoro di spinta nella fase di aspirazione che coincide con l'effetto di aspirazione.

Immagini radiologiche ottenute durante l'impiego di FREE ASPIRE. Si nota come le secrezioni rimangono dalla fase di aspirazione per poi finire nello stomaco inoltre l'aumento significativo della superficie ventilatoria e il motivo della riduzione della pressione all'interno delle vie aeree.



## MEDAX SRL

Via F.lli Rosselli, 4/A - 07100 SASSARI  
Tel. 079 2111504 - Fax 079 216876  
Part. IVA 02006260901

### Dati tecnici

Alimentazione: 220-230 V AC - 50 Hz  
Potenza assorbita: 140 W  
Fusibile: 250V, F500mA, 5mm  
Classe di protezione elettrica: II  
Tipo di parte applicata: B  
Dimensioni: 27 x 23 x 13 cm  
Peso: 2 kg  
Conformità: Direttiva DM 93/42/CEE classe IIa  
Norme applicate CEI EN 60601-1 (III ed) - CEI EN 60601-1-2:2001



Medical Products Research S.r.l.  
Via R. Curtice, 43/45 - 20025 LEGNANO (MI) Italy  
Tel: +39 0331 597 992 Fax: +39 0331 485 089  
e-mail: info@mpr-italy.it Web: www.mpr-italy.it