

VERBALE N. 1 seggio DI GARA

Invito a presentare offerta per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano, CIG 45590642A1

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 9,30, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Fabiola Murgia	Dirigente del Servizio Provveditorato	Presidente
Dr.ssa M. Gavina Daga	Collaboratore amm.vo Serv. Provveditorato	Testimone
Sig.ra M. Francesca Bianchi	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 864 del 26.09.2012 si provvedeva alla indizione della procedura in oggetto, approvazione dell'invito, del Capitolato Speciale e del Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- che gli atti sono stati pubblicati nel sito dell'Azienda Sanitaria, nella sezione "Bandi e Gare" dal 16.10.2012 e l'invito con nota prot. n. 66329 del 16.10.2012 è stato inoltrato agli operatori economici come indicati nell'elenco Ditte allegato al suddetto atto deliberativo: CISA, SORDINA, GENTIGE, ANALYTICAL CONTROL DE MORI, LABOINDUSTRIA;
- che sono state invitate con successive note tutte le società che hanno inoltrato richiesta di invito: ALEA Sas, GLM Srl, MANTA Srl, RAP Srl, SANDRO CARTA, STERIS Srl, EDILMED Sas;
- che in data 31.10.2012 sono stati pubblicati i chiarimenti richiesti dalle società interessate, e n. 2 precisazioni tecniche relative all'art. 3 del Capitolato Tecnico che si allegano al presente verbale ai nn. 1) e 2);
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 936 del 13.11.2012 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente procedura, costituita dal presente Seggio di gara e da distinta Commissione giudicatrice.

Il Presidente, alla presenza dei testimoni sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti in rappresentanza delle Ditte offerenti i Signori: Marco Ovidio Viridis per la società CISA SPA, Sig. Sandro Carta per la società SORDINA SPA. Per la società ALEA si presenta alle ore 9,52 il Sig. Merella Pierpaolo.

Il Presidente da atto e fa constatare palesemente che nel termine ultimo, fissato per il giorno 09.11.2012, ore 13,00, sono pervenuti N°5 pieghi generali contenenti l'offerta da parte delle società di seguito indicate:

- 1) Ditta STERIS Srl. plico pervenuto il 07.11.2012 e assunto a protocollo al n.72223 del 08.11.2012
- 2) Ditta GETINGE SPA, plico pervenuto il 08.11.2012 e assunto a protocollo al n.72717 del 09.11.2012
- 3) Ditta CISA SPA, plico pervenuto il 08.11.2012 e assunto a protocollo al n.72737 del 08.11.2012
- 4) Ditta SORDINA SPA, plico pervenuto il 08.11.2012 e assunto a protocollo al n.72726 del 09.11.2012
- 5) Ditta ALEA Sas, plico pervenuto il 09.11.2012 ore 12,30, e assunto a protocollo al n.72984 del 12.11.2012

Il Seggio di gara procede alla verifica della integrità e regolarità esterna dei plichi, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, apponendo sugli stessi la data odierna e le firme dei componenti il Seggio. Si da atto che i plichi risultano pervenuti nei termini e sono stati confezionati ed indirizzati conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

Concluso l'esame esteriore, il Presidente procede, nell'ordine sopraindicato, per ciascuna ditta offerente, all'apertura dei pieghi generali presentati ed alla verifica della materiale presenza, integrità e regolarità esterna delle buste contenenti l'offerta economica, la documentazione tecnica e la documentazione amministrativa. Le buste risultano sigillate ed intestate come da prescrizioni.

Procede quindi, per ciascuna ditta, all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e alla disamina del contenuto, così come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, verificando la completezza e la regolarità dei documenti amministrativi richiesti, in particolare:

1. **istanza di partecipazione**, in lingua italiana e **dichiarazione sostitutiva** resa dal Legale Rappresentate o Procuratore dell'impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l'unito Modello B, corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara ;
2. Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente **Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché dei chiarimenti indicati sul sito www.asioristano.it**;
3. verbale di sopralluogo **mod. D** per aver visionato il luogo di installazione delle apparecchiature;
4. dichiarazione di cui al **modello C** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del c.c.;
5. modulo offerta compilato **senza prezzi**, con indicazione delle apparecchiature offerte e relative dotazioni, accessori per renderle perfettamente funzionanti, e kit, così come richiesto nel Capitolato Tecnico;
6. **Eventuale procura**, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore.

Su tutta la documentazione amministrativa di cui sopra viene apposta la data odierna e la firma di tutti i componenti del Seggio.

Contestualmente alle operazioni di cui sopra, subito dopo la disamina della documentazione amministrativa il Seggio di gara procede, per ciascuna ditta, alla apertura della busta n° 3 contenente l'offerta tecnica dando conto pubblicamente della documentazione presentata, ed apponendo la data e la firma dei componenti il seggio sulla documentazione stessa, con espresso rinvio, per la valutazione della completezza e regolarità della stessa, alla Commissione Giudicatrice preposta alla verifica di conformità tecnica,

Si riepilogano di seguito le risultanze delle operazioni effettuate dal Seggio di Gara secondo quanto prescritto dall'art. 19 del C. S. A.:

N	Ditta offerente	Esito controllo documentale
1	STERIS Srl	Ammessa alla gara
2	GETINGE SPA	Ammessa alla gara, con richiesta di integrazione delle dichiarazioni personali del presidente CDA e del consigliere
3	CISA SPA	Ammessa con riserva: rilevato un contrasto tra la dichiarazione di cui all'allegato C di accettazione delle clausole onerose nel quale si cita espressamente l'art. 34 del CSA che rinvia al Capitolato Tecnico (art.5) in materia di consegna e collaudo e la dichiarazione prevista dal punto 2 dell'art. 12 del CSA di accettazione di tutte le clausole contenute nel capitolato Speciale e nel capitolato Tecnico. In tale ultima dichiarazione viene infatti inserita un'eccezione rispetto ai tempi di consegna proposti in 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione in luogo dei 30 gg indicati negli atti di gara.
4	SORDINA SPA	Ammessa alla gara con richiesta di integrazione della dichiarazione personale dell'amministratore della società unipersonale, che è socio di maggioranza della SORDINA SPA
5	ALEA Sas	Ammessa alla gara con richiesta di integrazione del prospetto delle forniture allegato all'istanza di partecipazione, con la precisazione dei nominativi dei clienti privati destinatari delle principali forniture, non indicati

Terminata questa operazione si procede, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico per l'estrazione delle Ditte che saranno invitate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nell'istanza di partecipazione. Atteso che il numero delle ditte estratte deve essere pari al 10% degli offerenti arrotondato all'unità superiore, e che il numero delle ditte partecipanti è pari a n° 5 (cinque) si procederà all'estrazione di n° 1 (una) ditta. I nominativi delle Ditte ammesse vengono riportati in appositi biglietti ripiegati e inseriti in un'urna di cartone. Il Sig. Sandro Carta, procede all'estrazione con il seguente risultato: ditta estratta GETINGE. I biglietti sono allegati al presente verbale, con il n. 3.

Eseguite le soprascritte operazioni il presidente procede alla raccolta delle buste contenenti le offerte economiche all'interno di un plico che viene chiuso, sigillato e controfirmato che, unitamente ai plichi relativi alla

Handwritten signatures and initials:
 F.H.
 M.F. Bianchi
 [Illegible signature]

documentazione amministrativa e alla documentazione tecnica, vengono prese in custodia dal Segretario del Seggio di gara.

I plichi contenenti la documentazione tecnica verranno trasmessi al Presidente della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione di conformità delle offerte, una volta sciolte le riserve.

La seduta si chiude alle ore 12,00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa Fabiola Murgia

Fabiola Murgia

I Testimoni:

Dr.ssa Maria Gavina Daga

Maria Gavina Daga

Sig.ra Maria Francesca Bianchi

Maria Francesca Bianchi

quest'ultima facente anche funzioni di Segretario verbalizzante.



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

CHIARIMENTI pubblicati il 31.10.2012

chiarimenti richiesti il 23.10.2012 relativamente alla parte amministrativa dell'offerta

Quesito 1

In data 21.08.2012 Codesta Spettabile Azienda aveva indetto procedura negoziata per la fornitura di n. 1 autoclave per il B.O. del nuovo edificio DEA del P.O. S. Martino di Oristano, successivamente revocata prima della presentazione delle offerte

- L'oggetto di tale procedura era il medesimo del cottimo fiduciario in oggetto
- Per tale fornitura era previsto sopralluogo al fine della presentazione dell'offerta
- In data 30/08/2012 un tecnico da noi incaricato ha effettuato detto sopralluogo, a seguito del quale ci è stato rilasciato il modulo "Dichiarazione di sopralluogo", sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica di Codesta Spettabile ASL
- Per la presentazione dell'offerta in oggetto è richiesto analogo sopralluogo

Siamo a richiederVi se, in luogo dell'Allegato Modello D "Verbale di Avvenuto Sopralluogo", sia possibile presentare la summenzionata "Dichiarazione di sopralluogo".

Risposta:

L'amministrazione accetta la "dichiarazione di sopralluogo" anche se in data antecedente alla presente procedura di cottimo. Tale deroga trova giustificazione nel fatto che la S.A. ha revocato la procedura precedente pertanto i sopralluoghi eseguiti relativamente al medesimo oggetto della gara di cui all'invito in data 21.08.2012 sono da ritenersi accettabili, al fine pure di non far ricadere ulteriori oneri a carico delle ditte partecipanti.

chiarimenti richiesti il 25.10.2012 relativamente alle caratteristiche tecniche

Quesito 2

all'art.3 "caratteristiche richieste" si cita la tipologia verticale passante; il termine verticale è riferito al tipo di scorrimento delle porte dell'autoclave stessa?

Risposta:

SI.



ASL 5 Oristano

Via Carducci n°35
09170 Oristano
www.asloristano.it

chiarimenti richiesti il 26.10.2012 relativamente alla documentazione amministrativa

Quesito 3 richiesto il 26.10.2012

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 'MODELLO B', al punto V) in relazione alla capacità tecnica, il citato 'prospetto allegato alla presente dichiarazione', deve essere redatto su un modello specifico o su carta intestata del soggetto candidato su proprio schema, a patto che siano indicate le caratteristiche richieste?

Risposta:

per la compilazione del prospetto delle principali forniture, che deve contenere l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, non è richiesto alcun modello specifico.

chiarimenti richiesti il 26.10.2012 relativamente alla documentazione amministrativa

Quesito 4

Con riferimento all'oggetto ed a quanto indicato all'art. 20 del Capitolato Speciale relativamente alla presenza dei soggetti candidati alle sedute pubbliche, siamo a chiederVi se la procura richiesta per presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale sia da intendersi come semplice delega o come procura notarile.

Risposta:

L'iscrizione a verbale di eventuali dichiarazioni può essere fatta dal legale rappresentante della società offerente ovvero da un suo delegato munito di procura notarile. Ai fini di presenziare solamente alle sedute del seggio non è richiesta al soggetto delegato la procura notarile.



Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

PRECISAZIONI TECNICHE pubblicate il 31.10.2012

di seguito si riportano evidenziate in grassetto alcune precisazioni tecniche, che completano l'articolo 3 del CAPITOLATO TECNICO:

Art. 3 Caratteristiche richieste

Caratteristiche tecniche dell'autoclave in configurazione base:

1. Conforme alla normativa 07/47/CEE in conformità al D.Lgs. n.37 del 25.01.2010
2. Di tipo Ospedaliera (Blocco Operatorio)
3. Completa di sistema di produzione autonoma del vapore
4. Tipologia **verticale** passante.
5. Porta con apertura di tipo verticale
6. Ingombro tale da essere perfettamente incassata nei locali di sterilizzazione del nuovo DEA (visibili in fase di sopralluogo). **A tal fine la Ditta dovrà curare anche i lavori di finitura relativi all'incasso a regola d'arte dell'autoclave completi di pannellature in acciaio inox per consentire la separazione tra zona sporca e zona pulita per tutta l'apertura dei locali fino al soffitto.**
7. Capacità di 8 Unità di sterilizzazione
8. Volume della camera di almeno 540 litri
9. Camera di sterilizzazione, intercapedini e porte in acciaio inossidabile
10. Struttura portante, pannellature frontali e interne in acciaio inossidabile
11. Sistema di controllo di tipo "touch screen"
12. Bassa rumorosità (circa 52 dB)
13. Bassa dissipazione elettrica
14. Guarnizioni ideali per una tenuta ottimale
15. In grado di eseguire il processo di sterilizzazione per la destinazione d'uso specifica "Blocco Operatorio Ospedaliero" conformemente a quanto indicato dalle fonti legislative e normative vigenti in materia e attualmente in vigore: UNI EN 285, UNI EN ISO 17665-1, ecc. (specificare le fonti normative/legislative di riferimento)
16. Concorreranno nella valutazione del prezzo le seguenti opzioni i cui valori dovranno essere quotati singolarmente nell'offerta economica:
17. Completa di sistema di gestione per controllare e registrare i parametri di lavoro nonché di sistema informatico per la gestione della tracciabilità. **Oltre al SW dovrà essere fornito tutto l'hardware necessario per il completamento del processo ovvero: computer, stampante laser, stampante di etichette, N° 2 dispositivi di lettura con codice a barre per le operazioni di scarico e carico e collegamento**

del sistema alla rete informatica per la piena operatività. Tale sistema dovrà eventualmente essere collegabile ed estendibile qualora l'azienda realizzi una propria centrale attraverso l'eventuale inserimento in una rete più ampia anche di diversi produttori.

18. Completa di sistema di osmosi per la produzione dell'acqua
- 19. Completa di N° 2 carrelli esterni e di N° 1 carrello interno in acciaio INOX ergonomici e maneggevoli per il carico e lo scarico del container.**
20. Smontaggio e rimontaggio in altra sede, ubicazione presso la nuova sala operatoria di Ginecologia e Ostetricia in fase di edificazione al quarto piano del P.O. San Martino (Corpo P) la cui data di montaggio nel 2013/14 sarà comunicata successivamente, dell'autoclave di marca Sordina attualmente ubicata presso il blocco operatorio e visibile in fase di sopralluogo.

L'intero sistema dovrà essere completo di N° 2 manuali d'uso in lingua italiana, ed un manuale di tecnico di service in formato cartaceo (entrambi i manuali dovranno essere consegnati in formato elettronico su supporto CD/DVD).

Per ognuna delle specifiche sopra riportate la ditta deve relazionare in merito alle caratteristiche del sistema offerto riportando gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta con chiara indicazione dei range di valori e delle unità di misura al fine di dimostrare come l'apparecchiatura proposta risponda ai bisogni rappresentati nel presente documento.

Si raccomanda di specificare e allegare documento con indicazione della destinazione d'uso per cui l'apparecchiatura è prodotta dal fabbricante completa di CODIFICA CIVAB e CODIFICA CND.



Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

PRECISAZIONI TECNICHE pubblicate il 31.10.2012

di seguito si riportano alcune precisazioni tecniche, che completano l'articolo 3 del CAPITOLATO TECNICO:

In relazione alla gara in oggetto considerate le esigenze manifestate in fase di sopralluogo si precisa quanto segue:

1. **Ingombro tale da essere perfettamente incassata nei locali di sterilizzazione del nuovo DEA (visibili in fase di sopralluogo).** Con questa frase si intende che l'installazione del nuovo macchinario non dovrà in alcun modo determinare lo spostamento dei piani di lavoro e degli arredi presenti nella zona sporco. I quali dovranno continuare ad essere perfettamente fruibili da parte degli operatori. E' ammesso un ingombro maggiore rispetto a quello attuale solo sul lato pulito ma non tale da rendere suddetto spazio non accessibile. In altre parole anche dal lato pulito l'operatore dovrà comunque poter accedere per poter effettuare le corrette operazioni di scarico. A tal fine si chiede di precisare con dettaglio tutti gli ingombri determinati dai macchinari presentati (compreso il sistema di osmosi) e di indicare con precisione la loro collocazione. **I macchinari che in termini di ingombro non dovessero rispettare i requisiti di compattezza sopra indicati saranno esclusi.**
2. In merito al sistema di tracciabilità si precisa che il computer gestionale deve poter essere collocato anche in altri locali presenti nel blocco operatorio (avvalendosi della rete informatica aziendale) al fine di limitare il più possibile l'ingombro nei locali sporco/pulito adiacenti al macchinario.



MESE 3 AL VERBALE DEL GIORNO DI GIURIA DEL 13.11.2012

PROCEURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
UN AUTOCLAVE PER IL CORPO DEA - CIG 45590642A1

1 STERIS MP

13 NOV. 2012

NON ESTRATTA MP
pubb. 13 NOV. 2012

GETINGE 1

NON ESTRATTA MP
pubb. 13 NOV. 2012

1 ALEA 13 NOV. 2012

NON ESTRATTA MP
pubb. 13 NOV. 2012

13 NOV. 2012

CISA 1

NON ESTRATTA MP
pubb. 13 NOV. 2012

13 NOV. 2012

1 SORDINA

NON ESTRATTA MP
pubb. 13 NOV. 2012

VERBALE N. 2 seggio DI GARA

Cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio, alle ore 10,30, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Fabiola Murgia	Dirigente del Servizio Provveditorato	Presidente
Dr.ssa M. Gavina Daga	Collaboratore amm.vo Serv. Provveditorato	Testimone
Sig.ra M. Francesca Bianchi	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

▲ che con verbale n.1 del 13.11.2012 il seggio di gara provvedeva alla ammissione alla gara delle società STERIS S.r.l., ALEA S.a.s., GETINGE SPA, SORDINA SPA

▲ che alle società ALEA S.a.s., GETINGE SPA, SORDINA SPA, è stato richiesto di integrare la documentazione amministrativa per le motivazioni contenute nel verbale n.1 di questo seggio di gara, e hanno provveduto a completare opportunamente le dichiarazioni ovvero a presentare la documentazione integrativa,

▲ che la società CISA SPA, è stata ammessa con riserva alla procedura di gara per le motivazioni indicate nel verbale n.1, ed ha provveduto all'accettazione delle condizioni del capitolato speciale, consentendo pertanto di sciogliere le riserve di ammissione alla gara,

▲ che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico per l'estrazione delle Ditte invitate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nell'istanza di partecipazione è risultata estratta la società GETINGE SPA alla quale è stato richiesto con nota protocollo n.73781 del 14.11.2012 di presentare la documentazione,

▲ che la società ha regolarmente presentato, con nota assunta a protocollo n.74854 del 19.11.2012, la documentazione richiesta che conferma quanto dichiarato in sede di autocertificazione;

▲ che in data 22.11.2012, con nota prot. n.4140161, **allegato con il n.1** al presente verbale, il Presidente del seggio di gara, per i successivi adempimenti relativi alla verifica di conformità delle offerte, provvedeva a trasmettere al Presidente ed ai Componenti della commissione giudicatrice la documentazione tecnica delle suddette società e la copia del citato Verbale n°1;

▲ che in data 23.04.2013 il presidente della Commissione Giudicatrice trasmetteva al Presidente del Seggio di gara la documentazione tecnica ed i verbali del 04.12.2012 e del 20.03.2013, **allegati con il n.2** al presente verbale, nell'ultimo dei quali si dà atto che nessuna delle offerte risulta conforme alle esigenze dell'azienda sanitaria indicate nel capitolato e in particolare nel chiarimento n.1 del 31.10.2012 in quanto gli ingombri risultano tali da non consentire le corrette manovre di scarico nella zona pulito, e altre determinando l'impossibilità della completa apertura della porta.

Dato atto che:

- il Presidente del Seggio di gara ha pertanto disposto la convocazione della seduta pubblica di conclusione del procedimento di gara

- che è stata data comunicazione della seduta in data odierna a mezzo fax protocollo n. 31290 del 30.04.2013 alle società offerenti;

Il Presidente, alla presenza dei testimoni sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti in rappresentanza delle Ditte offerenti i Signori: Sig. Giovanni Sanna per la società STERIS, Sig. Sandro Carta per la società SORDINA SPA. Per la società GETINGE il Sig. Cesari Umberto.

Il Presidente dà atto delle risultanze della verifica ex art.48 D.Lgs. n.163/2006 effettuato sulla società GETINGE e di seguito procede a dare lettura dei verbali della commissione giudicatrice ed invita i presenti a manifestare eventuali osservazioni da iscriverne a verbale. Constatato che alcun presente intende intervenire, dichiara la conclusione del procedimento con la non aggiudicazione della gara.

Alle ore 10,50 si presenta il Sig. Viridis Marco Ovidio in rappresentanza della società CISA, al quale vengono riassunte le motivazioni della non aggiudicazione della procedura e viene evidenziata in particolare la condizione della logistica del prodotto offerto dalla società rappresentata.

F. Murgia
M. Gavina Daga
Sig.ra M. Francesca Bianchi

La seduta si chiude alle ore 11,00.

il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa Fabiola Murgia

Fabiola Murgia

I Testimoni:

Dr.ssa Maria Gavina Daga

Maria Gavina Daga

Sig.ra Maria Francesca Bianchi

Maria Francesca Bianchi

quest'ultima facente anche funzioni di Segretario verbalizzante.



Allegato 1 al verbale del seggio di gara
del sette maggio 2013

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**

Prot. 4140/161

Oristano li, 22 NOV. 2012

Oggetto: **Trasmissione documentazione tecnica di gara:** fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1. Indizione con D.G. n.864 del 26.09.2012.

Al Presidente della Commissione giudicatrice
Ing. Barbara Podda – Servizio Ingegneria Clinica

p.c. ai Componenti la Commissione Giudicatrice:
Dr. Nicolò Orrù, Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri
Dr. Antonio Onorato Succu – Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.986 del 13.11.2012 (unita in copia alla presente), si trasmette, per gli adempimenti di verifica di conformità delle offerte, di competenza di codesta commissione giudicatrice, la documentazione tecnica delle società ammesse alla gara:

- 1) Ditta STERIS Srl.
- 2) Ditta GETINGE SPA
- 3) Ditta CISA SPA,
- 4) Ditta SORDINA SPA,
- 5) Ditta ALEA Sas,

Si da atto che le suddette società hanno presentato la documentazione richiesta a integrazione della documentazione amministrativa presentata che pertanto consente l'ammissione alla gara. La documentazione viene trasmessa unitamente a copia del verbale del seggio di gara in data 13.11.2012.

Gli atti relativi alla gara sono pubblicati sul sito ASL.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dr.ssa Fabiola Murgia

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel. 0783317790)

Allegato 2 al verbale del seggio di gara
del 04/05/2013 composto da n. 22 fogli

Buoni
23/4/13



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

S.S.D. Ingegneria Clinica

Oristano 23 04. 2013

Prot. n. 11929

Al Presidente del Seggio di Gara
c.a. Dott.ssa Fabiola Murgia

OGGETTO: "Invito a presentare offerta per la fornitura di n°1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG. 45590642A1".

In relazione alla procedura negoziata in oggetto si trasmette il verbale della Commissione Giudicatrice e la documentazione tecnica di gara.

Cordiali saluti,

**Il Presidente della Commissione
Giudicatrice
Ing. Barbara PODDA**

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

24 APR 2013

Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____



VERBALE N. 1 del 04.12.2012 della Commissione Giudicatrice

“Invito a presentare offerta per la fornitura di n°1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG. 45590642A1”.

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Dicembre, alle ore 16,00, nell'Ufficio del Presidente della Commissione Ing. Barbara Podda, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Ing. Barbara Podda

Dott. Nicolò Orrù

Dott. Antonio Onorato Succu

Dirigente Tecnico di Ingegneria Clinica

Direttore PP.OO. ASL N°5

Direttore Dipartimento Cure Chirurgiche ASL N° 5

Presidente

Componente

Componente

Il Presidente assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 986 del 13/11/2012 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal Seggio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice.

- Che con nota Prot. N. 4140161 del 22.11.2012 il Presidente del Seggio di Gara ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alla gara in oggetto comprensiva dei chiarimenti comunicati sul sito istituzionale in fase di pubblicazione.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

La commissione inizia l'analisi delle offerte tecniche e verifica che gli ingombri di alcune apparecchiature, in particolare quelle delle Ditte STERIS Srl, CISA SpA e Sordina SpA risultano di dimensioni molto elevate e dagli allegati tecnici di dettaglio sembrano incompatibili con i locali di destinazione anche in considerazione al chiarimento N°1 del 31.10.2012.

Per tale motivo la commissione decide di richiedere dei chiarimenti alle ditte summenzionate al fine di poter meglio capire la collocazione delle apparecchiature nell'ambito dei locali messi a disposizione e visitati in fase di sopralluogo.


La seduta si chiude alle ore 18,00.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ripone la documentazione in luogo sicuro in armadio chiuso a chiave.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Ing. Barbara PODDA




con funzioni di Segretario verbalizzante.

I Componenti:

Dott. Nicolò Orrù

Dott. Antonio Onorato Succu

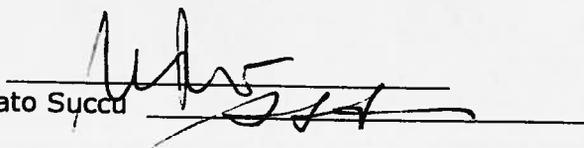

VERBALE N. 2 del 20.03.2013 della Commissione Giudicatrice

“Invito a presentare offerta per la fornitura di n°1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG. 45590642A1”.

L'anno duemilatredici, il giorno vent del mese di Marzo, alle ore 11,00, nell'Ufficio del Presidente della Commissione Ing. Barbara Podda, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Ing. Barbara Podda

Dirigente Tecnico di Ingegneria Clinica

Presidente

Dott. Nicolò Orrù

Direttore PP.OO. ASL N°5

Componente

Dott. Antonio Onorato Succu Direttore Dipartimento Cure Chirurgiche ASL N° 5

Componente

Il Presidente assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 986 del 13/11/2012 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal Seggio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice.
- Che con nota Prot. N. 4140161 del 22.11.2012 il Presidente del Seggio di Gara ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alla gara in oggetto comprensiva dei chiarimenti comunicati sul sito istituzionale in fase di pubblicazione.
- Che con nota Prot. N°606 del 04.01.2013 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha provveduto a richiedere delle planimetrie di dettaglio alle Ditte STERIS Srl, CISA SpA e Sordina SpA (di cui si allega copia);
- Che con note Prot. n.293338 del 11.01.2013 (Ditta Cisa) Rif. GC/bp 0005/13 del 08.01.2013 (Ditta Sordina) e Rif. VR/1213L170/CP (del 14.01.2013) le Ditte interpellate hanno fornito i chiarimenti richiesti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.


La commissione prosegue con l'analisi delle offerte tecniche e verifica che gli ingombri risultano tali da non consentire le corrette manovre di scarico nella zona pulito.

Al fine di poter meglio capire gli ingombri del macchinario attualmente installato rispetto a quello in corso di acquisizione l'ing. Podda (dopo aver verificato le dimensioni dei locali e della porta di accesso agli stessi) procede a disegnare in AUTOCAD le configurazioni offerte da tutte le Ditte. Tali disegni vengono quindi allegati agli atti del presente verbale.

Come facilmente visibile nell'allegato 1 (riportante la situazione attuale) il macchinario ed il relativo carrello per lo scarico offrono delle sufficienti aree di manovra.

I macchinari offerti dalle Ditte ALEA, STERIS e CISA, riportati con le dimensioni indicate in offerta nella planimetria dei locali di destinazione, non consentono la corretta apertura della porta di accesso ai locali ed il corretto adagiamento del carrello da 8 U.S. facente parte della fornitura (come da disegno di dettaglio allegato al presente verbale).

I macchinari offerti dalle Ditte GETINGE e SORDINA, riportati con le dimensioni indicate in offerta nella planimetria dei locali di destinazione, pur consentendo la corretta apertura della porta di accesso ai locali non permettono il corretto adagiamento del carrello da 8 U.S. facente parte della

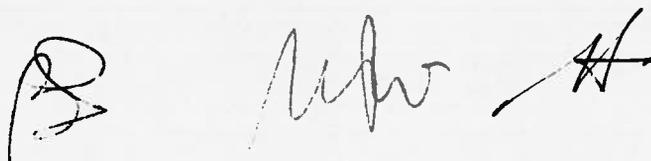

fornitura per l'effettuazione delle manovre di scarico da parte degli operatori (come da disegno di dettaglio allegato al presente verbale).

Per tali motivazioni nessuna delle offerte risulta conforme alle esigenze dell'azienda secondo le disposizioni del capitolato tecnico ed in particolare secondo quanto previsto dal chiarimento N° 1 del 31.10.2012 allegato al presente verbale.


La seduta si chiude alle ore 14,00.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ripone la documentazione in luogo sicuro in armadio chiuso a chiave, prima della riconsegna all'Ufficio Competente.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Ing. Barbara PODDA




con funzioni di Segretario verbalizzante.

I Componenti:

Dott. Nicolò Orrù

Dott. Antonio Onorato Succu

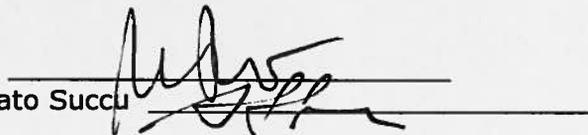

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**

Prot. 606

Oristano li, 04.01.2013

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1 D.G. n.864 del 26.09.2012:
Richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica.

**Spett.le Ditta CISA SPA
Via Pontina, Km 28
00040 POMEZIA
Racc. a.r. Anticipata al fax 06.9107565**

Facendo seguito alla seduta pubblica di ammissione alla gara in data 13.11.2012, si comunica che la gara è nella fase di valutazione di conformità delle offerte tecniche.

A tale riguardo si chiedono i seguenti chiarimenti:

Nel disegno relativo all'installazione la collocazione dell'apparecchiatura ingombra per quasi 1 metro lo spazio di lavoro dell'area sporca non rendendo fruibile parte del piano di lavoro contravvenendo a quanto indicato a pena di esclusione nelle precisazioni tecniche del 31.10.2012 dove si diceva che risultava ammissibile un ingombro maggiore rispetto a quello attuale solo sul lato pulito.



Si richiede pertanto alla Ditta se confermano la dislocazione indicata o se c'è possibilità di montare in maniera più compatta l'autoclave e il sistema di osmosi. In tal caso si prega di riportare con un disegno grafico la collocazione del sistema di osmosi e dell'autoclave (con chiara indicazione delle dimensioni, degli allacci e dei pannelli frontali di accesso ai macchinari) rispondendo a tutti i requisiti di sicurezza indicati dai produttori degli stessi macchinari e manifestati dall'azienda Sanitaria nell'ambito del presente appalto anche in considerazione delle precisazioni del 31.10.2012. Si tenga in considerazione anche la presenza degli allacci visualizzati in fase di sopralluogo che ovviamente non possono essere spostati.

I chiarimenti dovranno essere trasmessi a questa commissione giudicatrice entro il 11.01.2013 a mezzo fax al n°0783.73315 (servizio provveditorato) o alla mail provveditorato@asloristano.it, con successiva consegna dell'originale per posta.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Ing. Barbara Podda

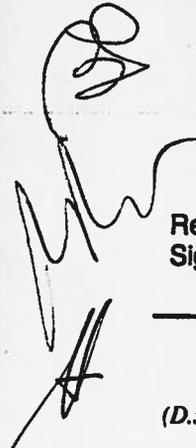

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel. 0783317790)

ASL 5 Oristano
Direttore del servizio
(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail: provveditorato@asloristano.it

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**

Prot. 606

Oristano lì, 04.01.2013

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1 D.G. n.864 del 26.09.2012: **Richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica.**

**Spett.le Ditta SORDINA SPA
Via Emilia Romagna, 9
35020 SAONARA
racc. a.r. anticipata al fax 049.8790377**

Facendo seguito alla seduta pubblica di ammissione alla gara in data 13.11.2012, si comunica che la gara è nella fase di valutazione di conformità delle offerte tecnica.

A tale riguardo si chiedono i seguenti chiarimenti:

Non è presente un disegno relativo all'installazione. Si dichiara che la collocazione dell'apparecchiatura sia uguale, sul lato frontale, a quella attuale. Non risulta chiaro come il sistema di osmosi BW90 andrebbe collocato nella nicchia a sinistra nella zona pulito come dichiarato visto che se così fosse un fianco della sterilizzatrice si sovrapporrebbe al lato frontale del sistema di osmosi, rendendo lo stesso inaccessibile.

Si richiede pertanto alla Ditta di indicare con un disegno grafico la collocazione del sistema di osmosi e dell'autoclave (con chiara indicazione delle dimensioni, degli allacci e dei pannelli frontali di accesso ai macchinari) rispondendo a tutti i requisiti di sicurezza indicati dai produttori degli stessi e manifestati dall'azienda Sanitaria nell'ambito del presente appalto anche in considerazione delle precisazioni pubblicate il 31.10.2012, che limitano le possibilità di ingombro. Si tenga in considerazione anche la presenza degli allacci visualizzati in fase di sopralluogo che ovviamente non possono essere spostati.

I chiarimenti dovranno essere trasmessi a questa commissione giudicatrice entro il **11.01.2013** a mezzo fax al n°0783.73315 (servizio provveditorato) o alla mail provveditorato@asloristano.it, con successiva consegna dell'originale per posta.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Ing. Barbara Podda
Barbara Podda

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel. 0783/73315)

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail: provveditorato@asloristano.it



SERVIZIO PROVVEDITORATO

Prot. 606

Oristano lì, 09 01 2013

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano, CIG 45590642A1 D.G. n.864 del 26.09.2012:
Richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica.

Spett.le Ditta STERIS Srl
Via Cassanese, 224
Centro dir.le MI OLTRE Pal. Caravaggio
20090 SEGRATE
Racc. a.r. Anticipata al fax 02.21303483

Facendo seguito alla seduta pubblica di ammissione alla gara in data 13.11.2012, si comunica che la gara è nella fase di valutazione di conformità delle offerte tecniche.

A tale riguardo si chiedono i seguenti chiarimenti:

Nel disegno relativo all'installazione la collocazione dell'apparecchiatura ingombra per oltre 1 metro lo spazio di lavoro dell'area sporca non rendendo fruibile parte del piano di lavoro e contravvenendo in questo modo a quanto indicato a pena di esclusione nelle precisazioni tecniche del 31.10.2012 dove si diceva che risultava ammissibile un ingombro maggiore rispetto a quello attuale solo sul lato pulito.

Non si può pensare peraltro di spostare in avanti il macchinario per sovrapporlo in parte al sistema di osmosi proposto perché andrebbe a coprire il pannello frontale dello stesso.

Si richiede pertanto alla Ditta se confermano la dislocazione indicata o se c'è possibilità di montare in maniera più compatta l'autoclave e il sistema di osmosi. In tal caso si prega di riportare con un disegno grafico la collocazione del sistema di osmosi e dell'autoclave (con chiara indicazione delle dimensioni, degli allacci e dei pannelli frontali di accesso ai macchinari) rispondendo a tutti i requisiti di sicurezza indicati dai produttori degli stessi macchinari e manifestati dall'azienda Sanitaria nell'ambito del presente appalto anche in considerazione delle precisazioni del 31.10.2012. Si tenga in considerazione anche la presenza degli allacci visualizzati in fase di sopralluogo che ovviamente non possono essere spostati.

I chiarimenti dovranno essere trasmessi a questa commissione giudicatrice entro il 11.01.2013 a mezzo fax al n°0783.73315 (servizio provveditorato) o alla mail provveditorato@asl.oristano.it, con successiva consegna dell'originale per posta.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Ing. Barbara Rodda

Barbara Rodda

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel. 0783317790)

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail: provveditorato@asl.oristano.it

ASL Oristano

Pag. 1 di 1



Feel the innovation



Pomezia, 11.01.2013

Spett.le
AZIENDA S. L. N.5
Via Carducci, 35
09170 ORISTANO

Prot. n.293338
Div. Vendite UC/FE/eb

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare c/o il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. S. Martino di Oristano. CIG 45590842A1.

Richiesta chiarimenti relativi all'offerta tecnica, rif. Vs. prot. n.606 del 04.01.2013.

In riferimento alla procedura di cui in oggetto ed alla Vs. richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica con prot. n.606 del 04.01.u.s., con la presente, ci preghiamo trasmetterVi l'indicativo d'installazione inserito nella documentazione di gara debitamente aggiornato a seguito di quanto specificato nella Vs. suddetta richiesta.

Distinti Saluti.

CISA S.p.A.
Un Procuratore
Franco Emaguetti
Emmanuel Franco

Data 8 gennaio 2013

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Provveditorato
Via Carducci 35
09170 Oristano

Riferimento GC/bp 0005/13

Raccomandata A/R
Anticipata a mezzo fax al n. 0783 73315 e
A mezzo e-mail all'indirizzo provveditorato@asl.oristano.it

OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di 1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il Blocco Operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano.
CIG. 45590642A1 DG n. 864 del 26.09.12.
Rif. Vs. Lettera Invito Prot. n. 66329 del 16.10.2012.
Na. offerta n. 2012159 I.
Vs. prot. n. 606 del 04.01.13 - Richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica.


Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica (Vs. prot. n. 606 del 04.01.13), oltre ai Disegni di Installazione forniti in sede di gara, trasmettiamo in allegato il Disegno Grafico relativo alla collocazione del sistema osmosi e dell'autoclave, nel quale sono poste in evidenza le Informazioni richieste da Codesta Spettabile Azienda, e in particolare:

- Manutenzione autoclave sterilizzatrice proposta di tipo frontale tramite 4 porte (2 per fronte macchina)
- Manutenzione impianto ad osmosi di tipo frontale e/o superiore
- Tutte le tubazioni sono idonee al trasporto di acqua osmotizzata
- Tutte le tubazioni sono di tipo flessibile per permettere la movimentazione dell'impianto ad osmosi per eventuale manutenzione straordinaria

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Con i nostri migliori saluti.

Sordina S.p.A.
R&D
Nicola Mangiaracina

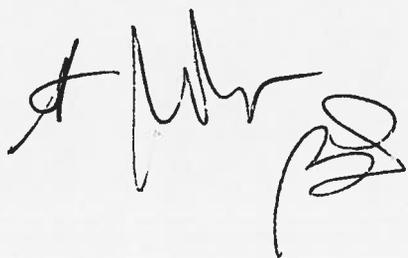

STERIS[®]

ASL N. 5 - ORISTANO
Resp. Proc. PROVATO
PERVENUTO IL
14 GEN. 2013
Prot. n. 3238 del 15 GEN. 2013
Alleg. VR/1213L170CF
prot 606 del 4/01/13

F. Biondini
15/1/2013
BY

Spett.le
ASL ORISTANO
Via Carducci 35
09170 ORISTANO

N. Rif.:

V. Rif.:

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE DA UBICARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL NUOVO EDIFICIO DEA DEL PO SAN MARTINO DI ORISTANO.

In relazione alla Vostra richiesta Prot. 606 del 4 gennaio u.s., si dichiara la possibilità di modificare la dislocazione delle apparecchiature oggetto della fornitura.

Analizzato lo spazio di ingombro delle apparecchiature, degli arredi e del raggio di attività degli operatori è stato possibile collocare le attrezzature come riportato nel disegno1 allegato.

In particolare:

- Il sistema ad osmosi BW150 si può installare in modo più compatto separando l'unità di trattamento (ingombro esterno LxPxH= 430x530x1260 mm) dal serbatoio di accumulo (ingombro esterno LxPxH= 400x400x1000 mm)
- L' autoclave Envister 8US (dimensioni esterne LxPxH= 1150x1592x1900 mm) si può collocare a cavaliere con ingombro nel solo lato pulito mantenendo comunque sia la fruibilità dell'area da parte degli operatori (spazio di manovra frontale per lo scarico pari a 1020 mm), sia lo spazio laterale idoneo per la manutenzione delle attrezzature.

Si precisa altresì che:

1. Come mostrato nel disegno 2 allegato, per agevolare le operazioni di carico/scarico e movimentazione strumentario si potranno sdoppiare i carrelli esterni da 8 US (ingombro esterno LxP= 650x1200 mm) in due carrelli da 4 US (ingombro esterno LxP= 650x670 mm)
2. La nuova collocazione delle attrezzature non altera le predisposizioni impiantistiche
3. Un apposito sistema di pannellatura bifacciale in acciaio inox garantirà la chiusura tra la zona di confezionamento/lavaggio e la zona sterile
4. In merito al sistema di rintracciabilità, il computer gestionale potrà essere collocato, a seconda delle esigenze del reparto, anche in altri locali presenti nel blocco operatorio utilizzando la rete informatica aziendale.


Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse necessitare e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STERIS S.r.l.
Carlo Patti
PROCURATORE SPECIALE

STERIS s.r.l. - Direzione e Coordinamento STERIS Corporation - USA
Strada Cassanese 224 - Centro Direzionale Milano O'tre - Palazzo Caravaggio - 20090 SEGRATE (MI)
Tel. +39 02 21 30 34 | ric.aut. Fax +39 02 21 30 34 84

DISEGNO 2

[Handwritten signature]

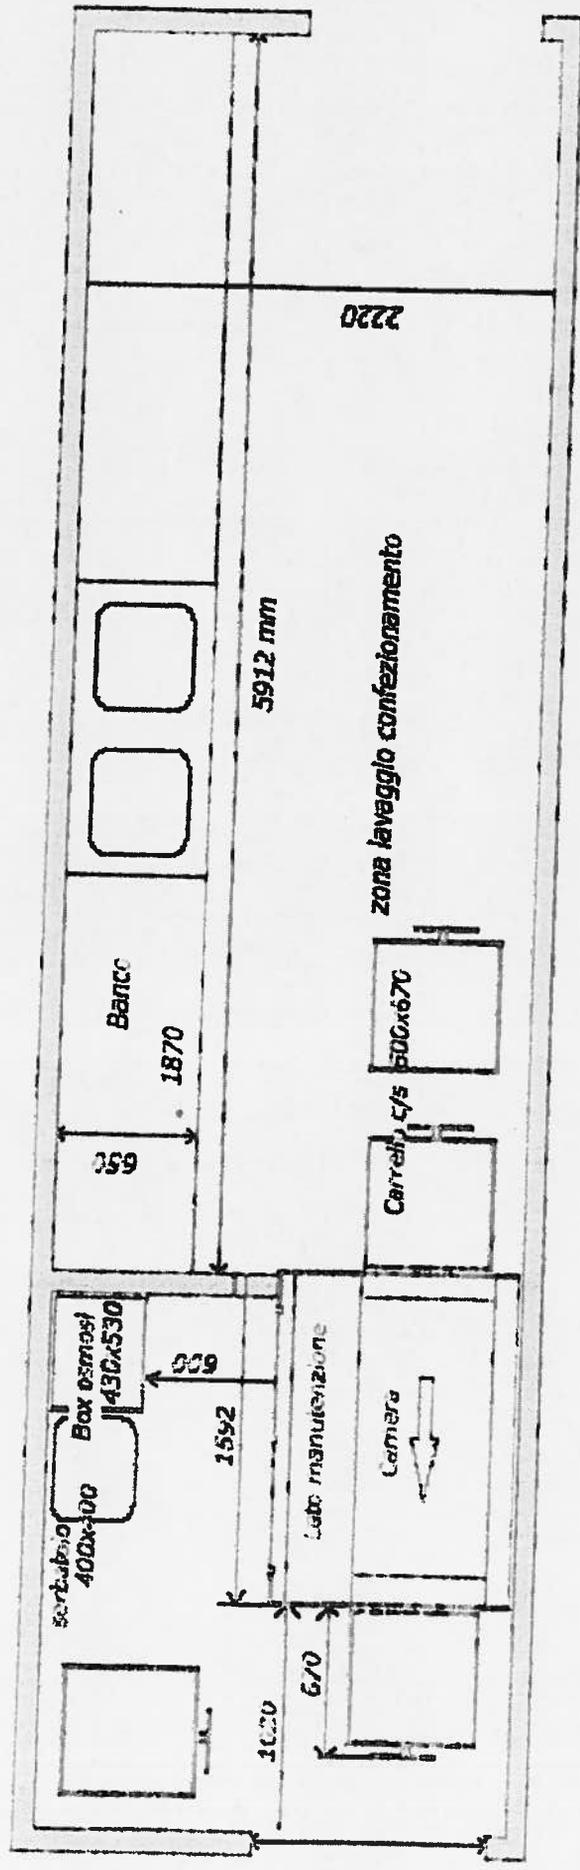

Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

PRECISAZIONI TECNICHE pubblicate il 31.10.2012

di seguito si riportano alcune precisazioni tecniche, che completano l'articolo 3 del CAPITOLATO TECNICO:

In relazione alla gara in oggetto considerate le esigenze manifestate in fase di sopralluogo si precisa quanto segue:



1. **Ingombro tale da essere perfettamente incassata nei locali di sterilizzazione del nuovo DEA (visibili in fase di sopralluogo).** Con questa frase si intende che l'installazione del nuovo macchinario non dovrà in alcun modo determinare lo spostamento dei piani di lavoro e degli arredi presenti nella zona sporco. I quali dovranno continuare ad essere perfettamente fruibili da parte degli operatori. E' ammesso un ingombro maggiore rispetto a quello attuale solo sul lato pulito ma non tale da rendere suddetto spazio non accessibile. In altre parole anche dal lato pulito l'operatore dovrà comunque poter accedere per poter effettuare le corrette operazioni di scarico. A tal fine si chiede di precisare con dettaglio tutti gli ingombri determinati dai macchinari presentati (compreso il sistema di osmosi) e di indicare con precisione la loro collocazione. I macchinari che in termini di ingombro non dovessero rispettare i requisiti di compattezza sopra indicati saranno esclusi.
2. In merito al sistema di tracciabilità si precisa che il computer gestionale deve poter essere collocato anche in altri locali presenti nel blocco operatorio (avvalendosi della rete informatica aziendale) al fine di limitare il più possibile l'ingombro nei locali sporco/pulito adiacenti al macchinario.



A
M
S



ALLEGATO 1

SITUAZIONE ATTUALE

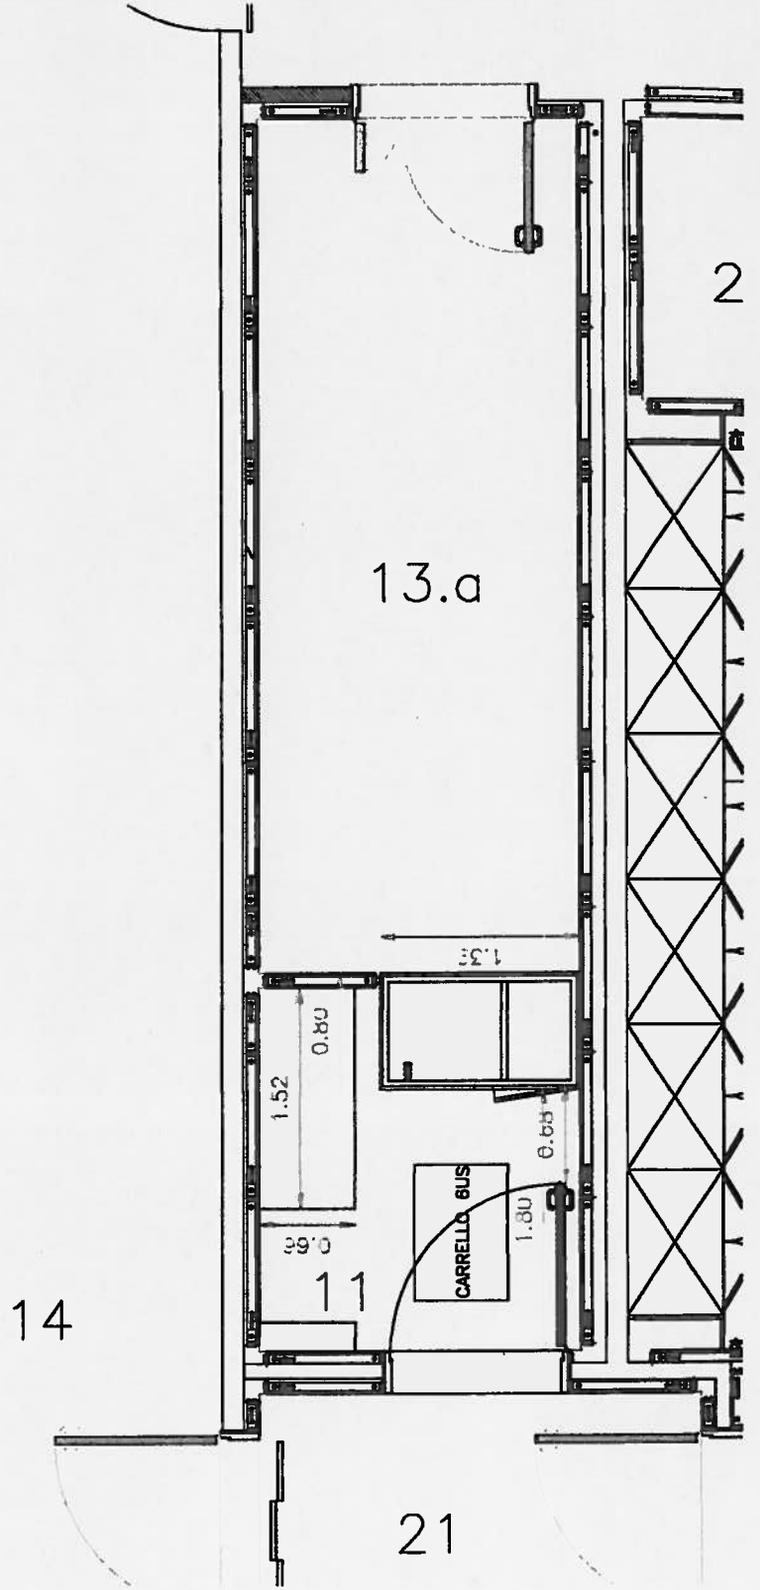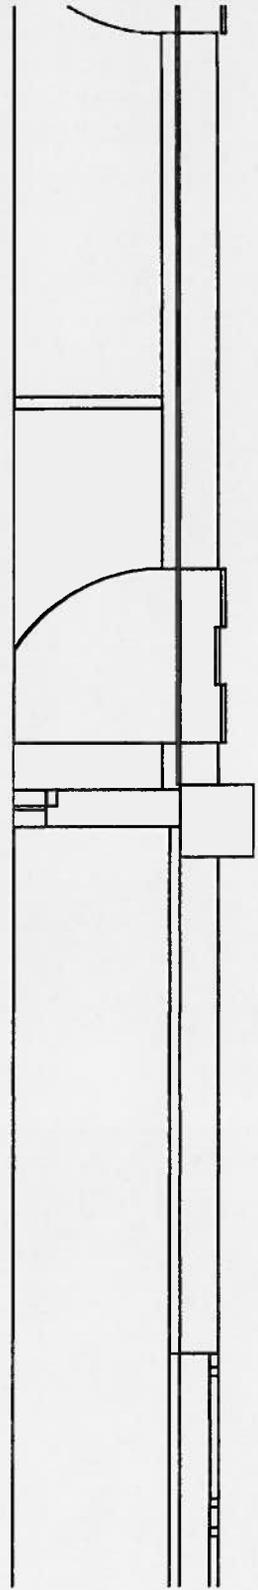



Handwritten signature and date: *[Signature]* 20

SITUAZIONE ALEA

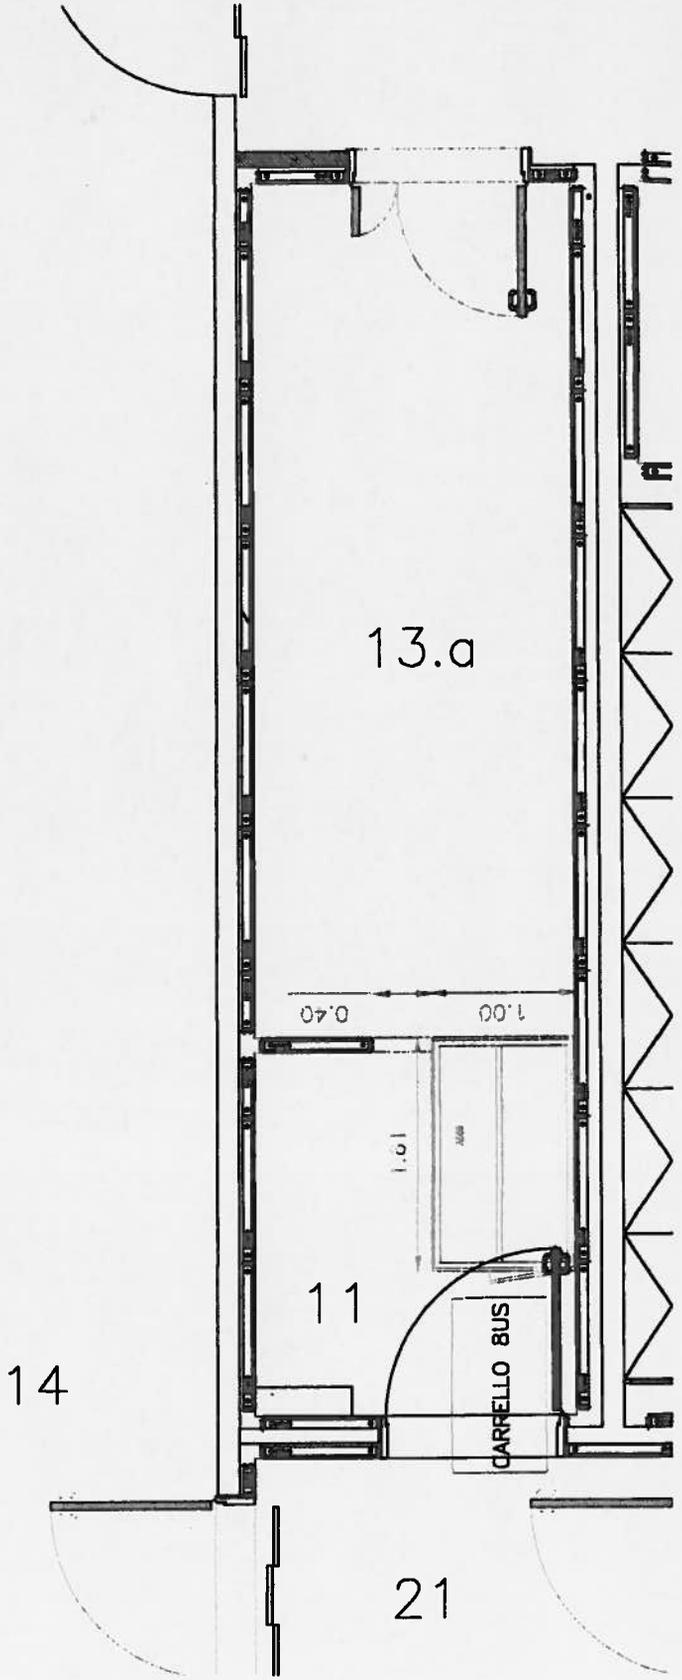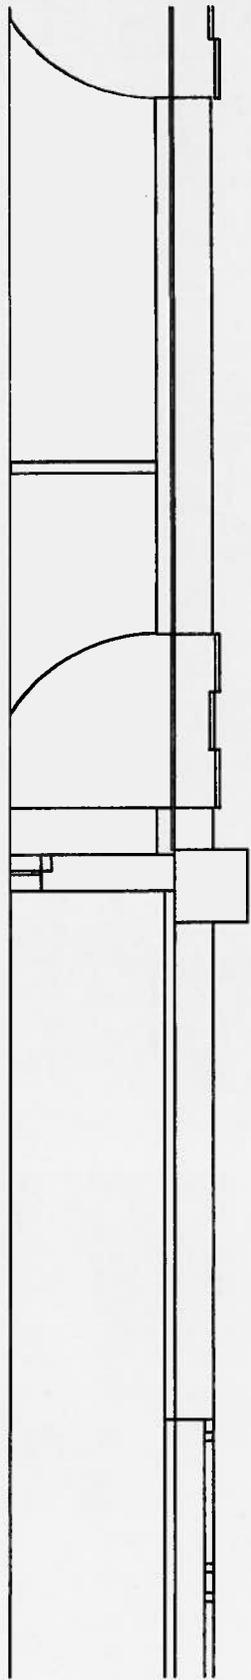



[Handwritten signature and scribbles]

SITUAZIONE STERIS s.r.l.

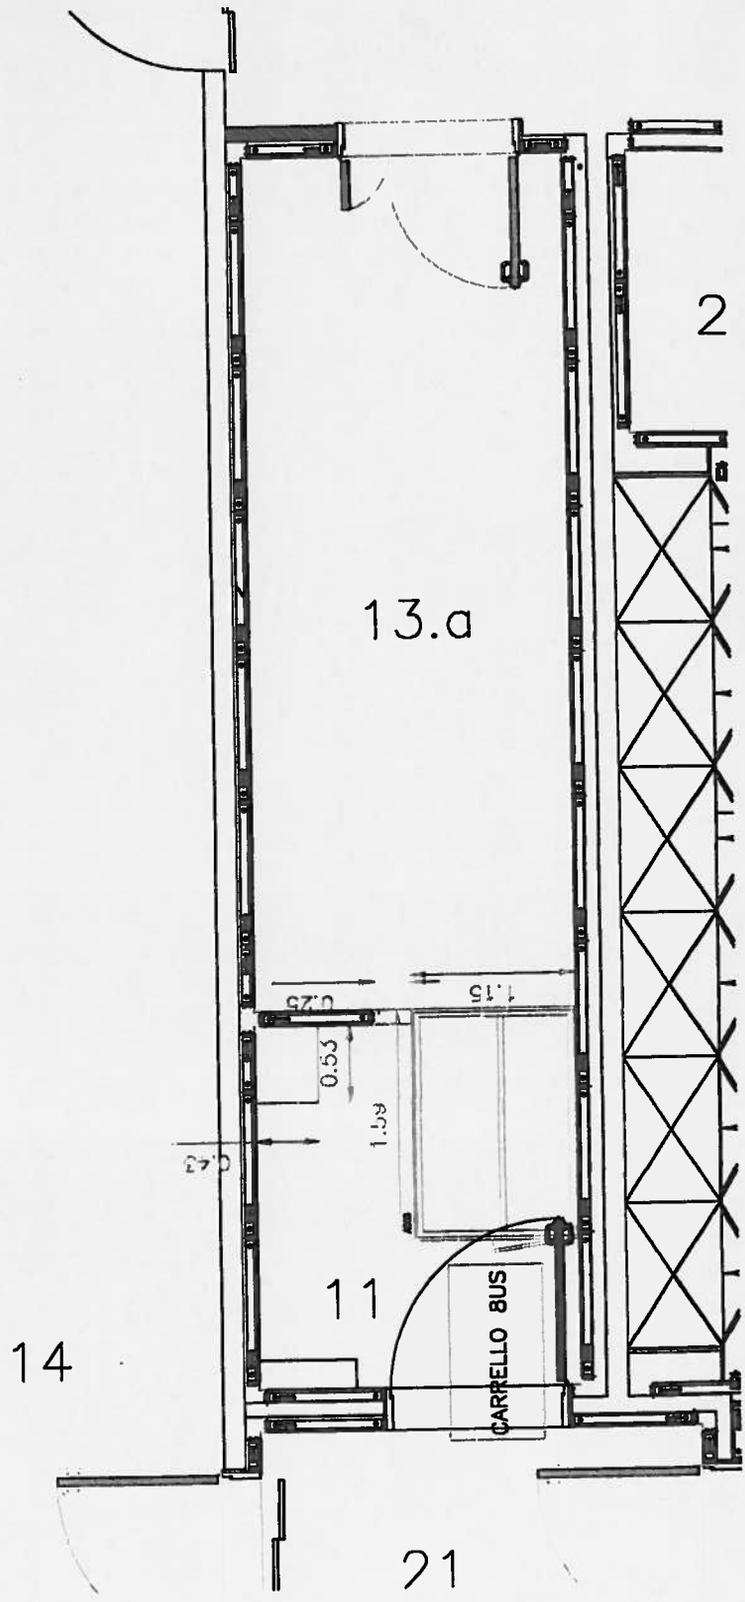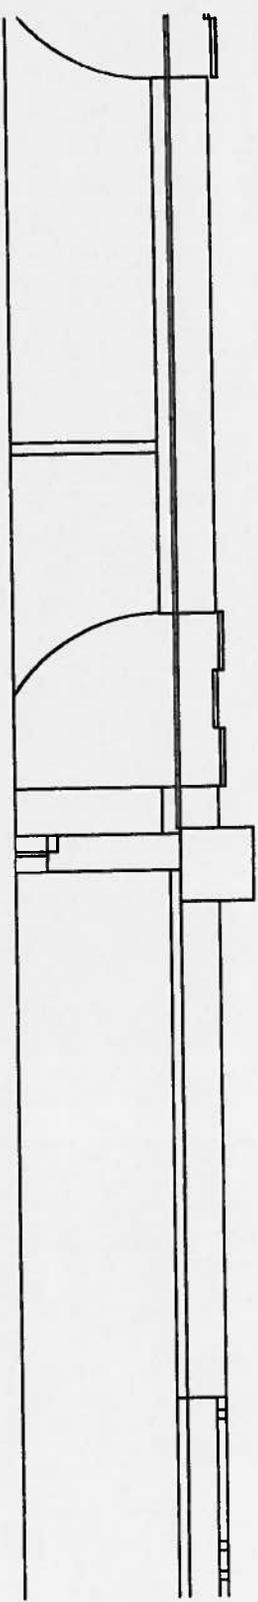



[Handwritten signature]

PROPOSTA CISA

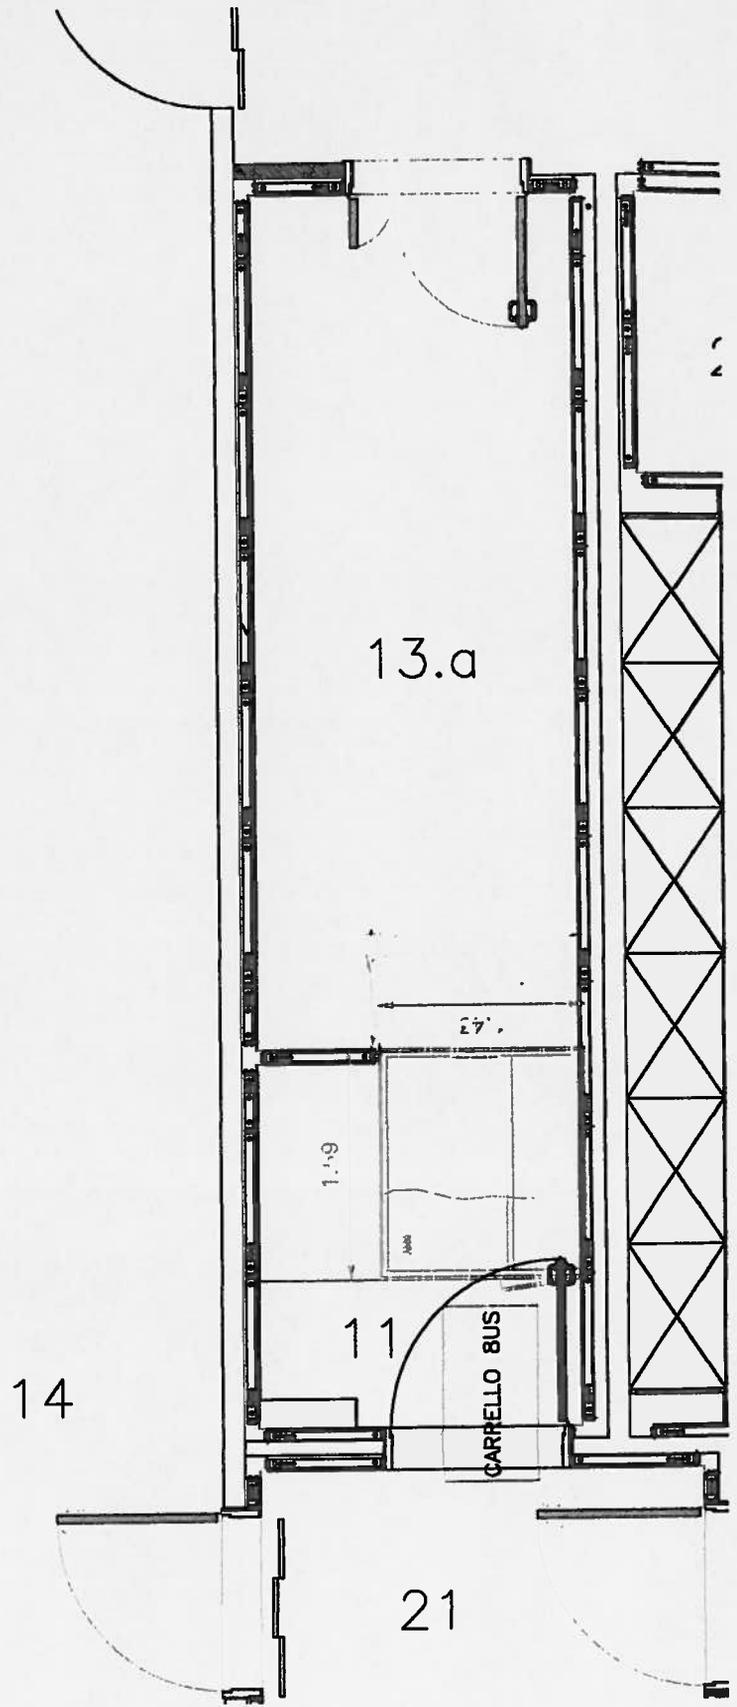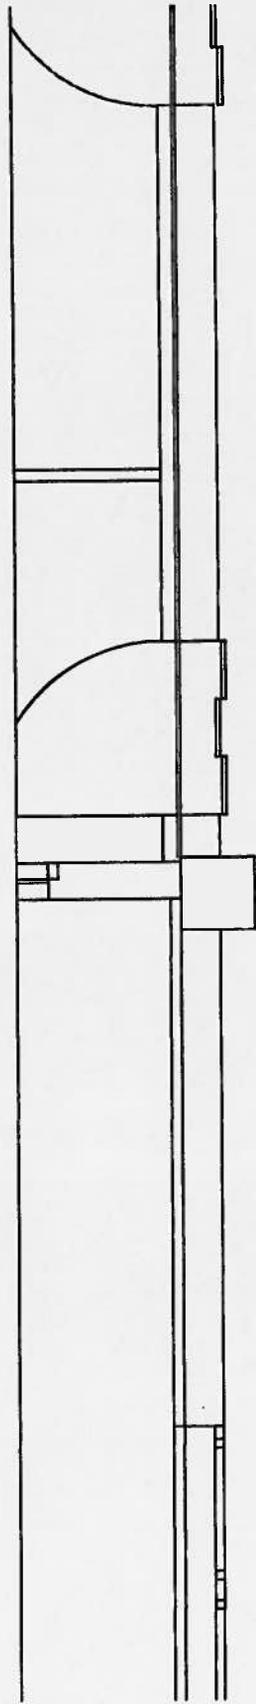

[Handwritten signatures and initials]


SITUAZIONE GETINGE

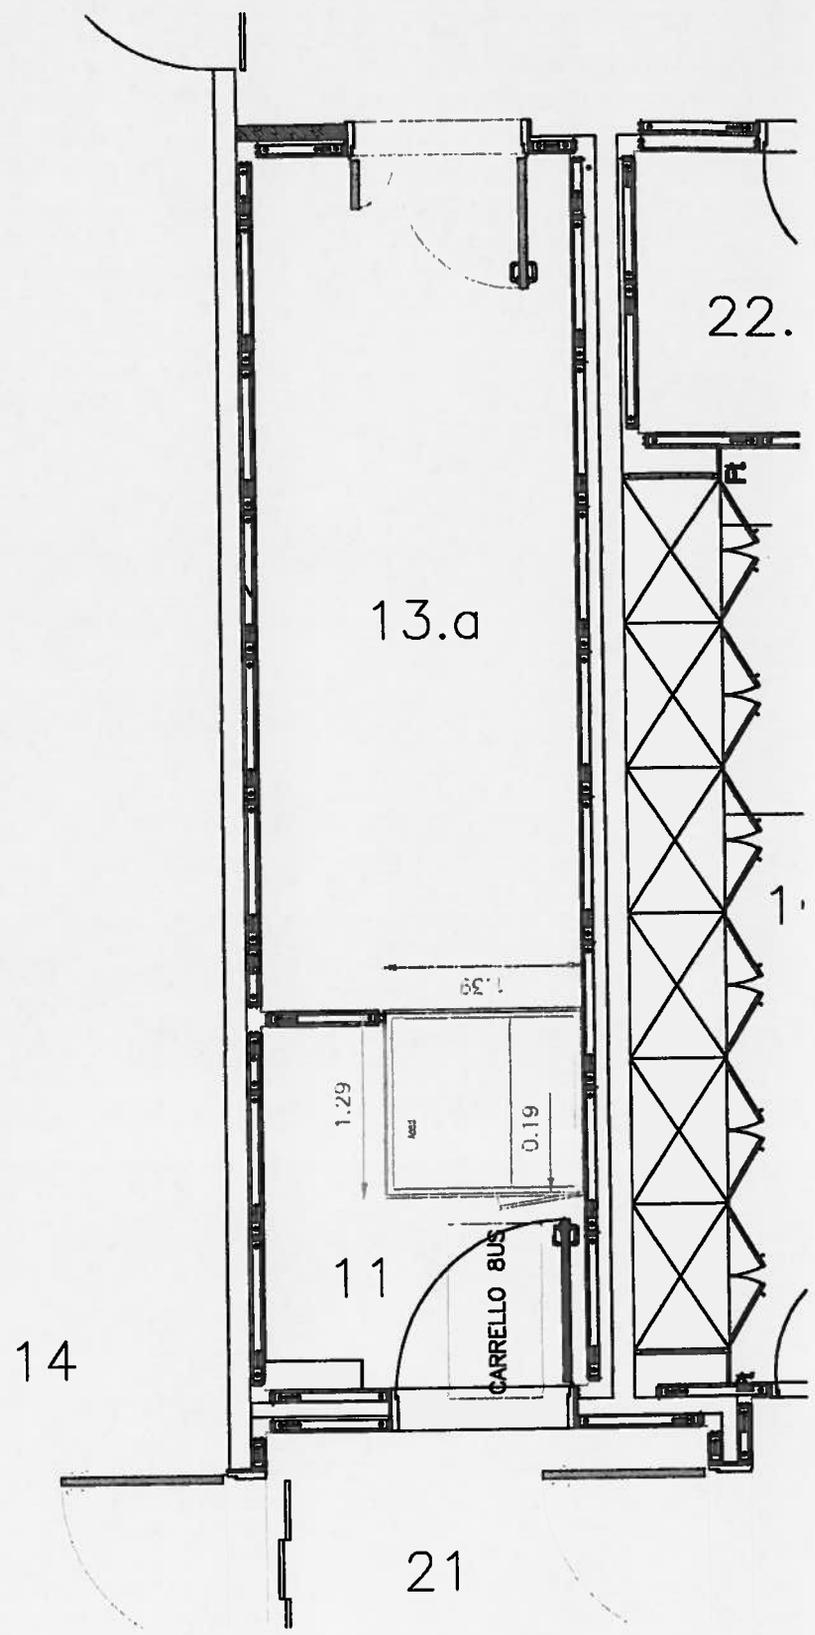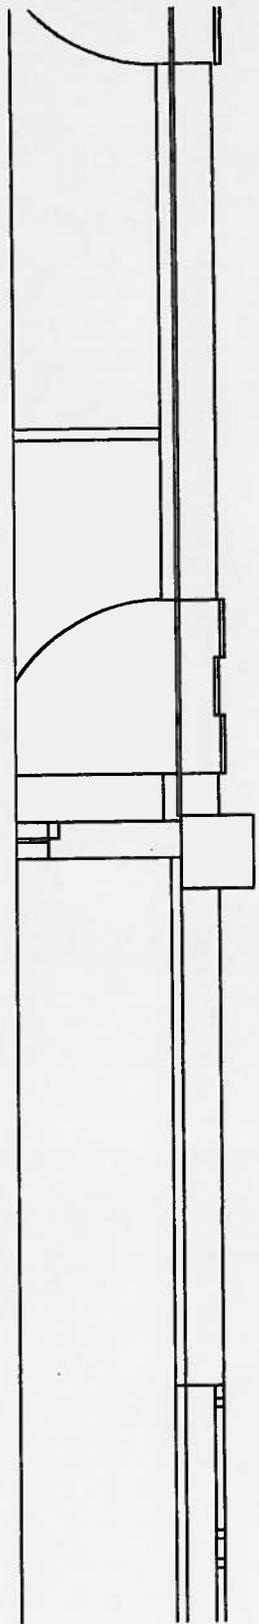


[Handwritten signature]

SITUAZIONE SORDINA S.P.A

[Handwritten signatures and initials]

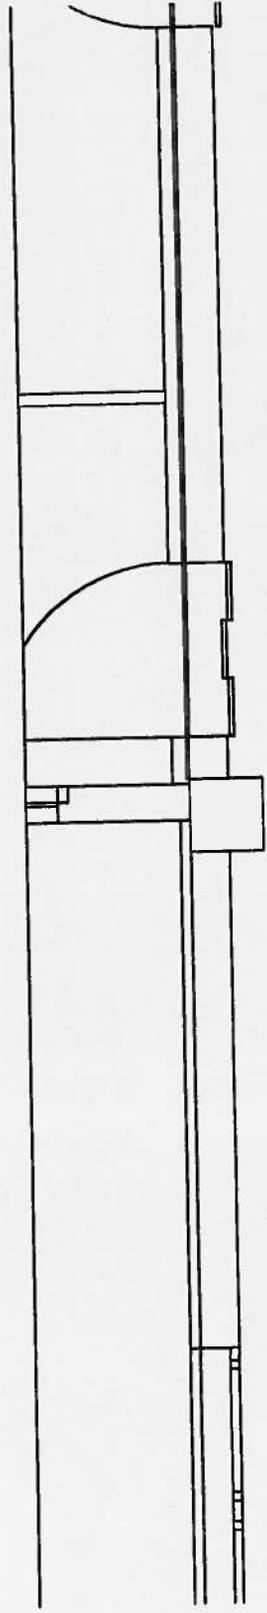

14

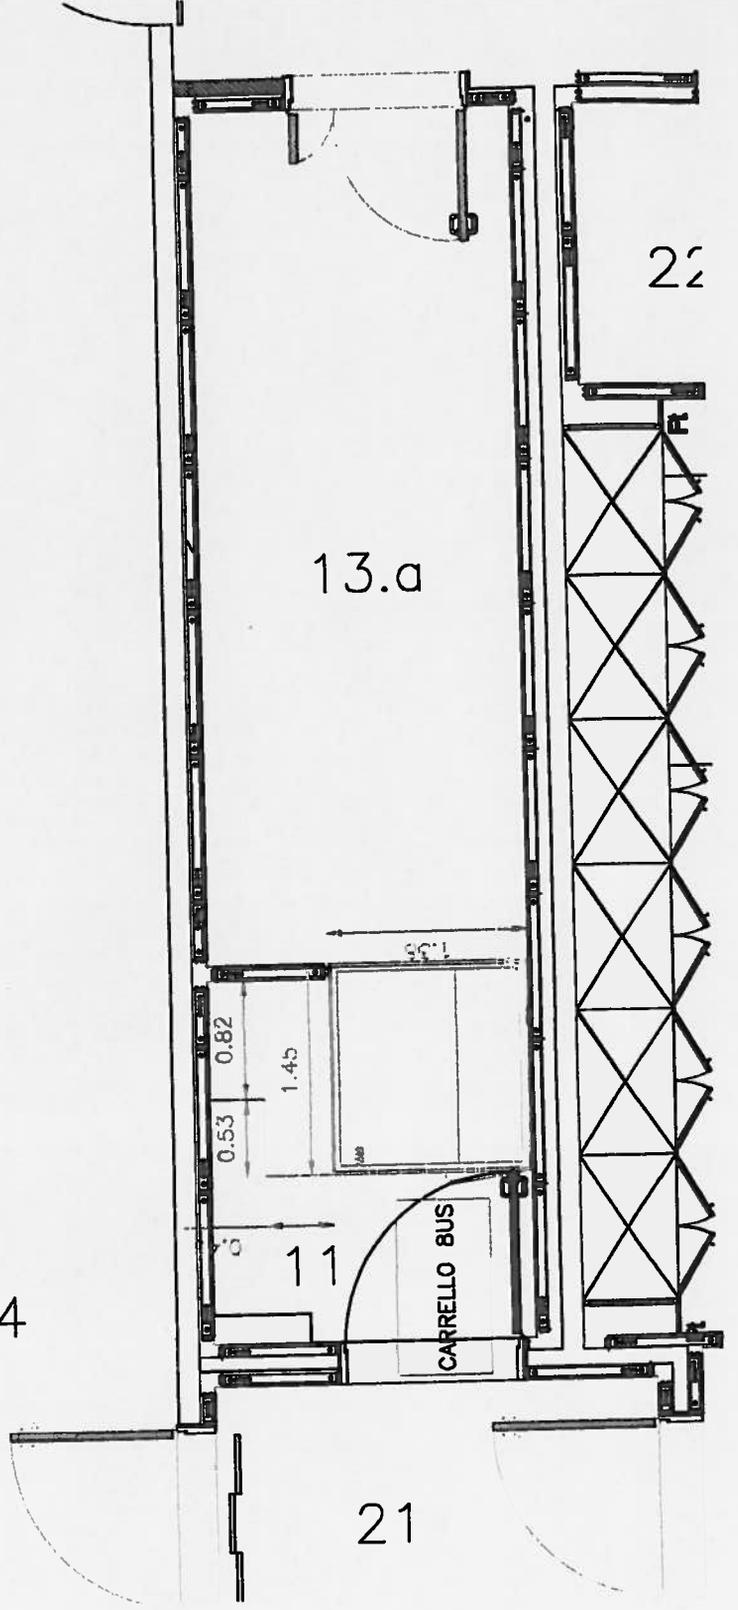

21

13.a

22